
**Matériel d'anesthésie et de
réanimation respiratoire — Canules
oropharyngées**

Anaesthetic and respiratory equipment — Oropharyngeal airways

**iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)**

[ISO 5364:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016>



iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

[ISO 5364:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016>



DOCUMENT PROTÉGÉ PAR COPYRIGHT

© ISO 2016, Publié en Suisse

Droits de reproduction réservés. Sauf indication contraire, aucune partie de cette publication ne peut être reproduite ni utilisée sous quelque forme que ce soit et par aucun procédé, électronique ou mécanique, y compris la photocopie, l'affichage sur l'internet ou sur un Intranet, sans autorisation écrite préalable. Les demandes d'autorisation peuvent être adressées à l'ISO à l'adresse ci-après ou au comité membre de l'ISO dans le pays du demandeur.

ISO copyright office
Ch. de Blandonnet 8 • CP 401
CH-1214 Vernier, Geneva, Switzerland
Tel. +41 22 749 01 11
Fax +41 22 749 09 47
copyright@iso.org
www.iso.org

Sommaire

Page

Avant-propos	iv
Introduction	v
1 Domaine d'application	1
2 Références normatives	1
3 Termes et définitions	1
4 Désignation des tailles et dimensions	2
4.1 Désignation de la taille.....	2
4.2 Dimensions.....	3
5 Matériaux	3
6 Conception	3
7 Exigences de performance	3
7.1 Résistance à l'aplatissement de la pièce buccale.....	3
7.2 Non-occlusion de la lumière.....	4
8 Assurance de stérilité	4
9 Emballage des canules oropharyngées fournies stériles	4
10 Marquage	4
10.1 Généralités.....	4
10.2 Utilisation de symboles.....	4
10.3 Marquage des canules oropharyngées.....	4
10.4 Marquage des emballages individuels.....	6
10.5 Marquage des emballages de protection ou de groupage.....	6
11 Informations à fournir par le fabricant	6
Annexe A (informative) Justificatif	7
Annexe B (normative) Méthode d'essai de la résistance à l'aplatissement de la pièce buccale	9
Annexe C (normative) Méthode d'essai de non-occlusion de la lumière	11
Annexe D (informative) Lignes directrices relatives aux matériaux et à la conception	13
Bibliographie	14

Avant-propos

L'ISO (Organisation internationale de normalisation) est une fédération mondiale d'organismes nationaux de normalisation (comités membres de l'ISO). L'élaboration des Normes internationales est en général confiée aux comités techniques de l'ISO. Chaque comité membre intéressé par une étude a le droit de faire partie du comité technique créé à cet effet. Les organisations internationales, gouvernementales et non gouvernementales, en liaison avec l'ISO participent également aux travaux. L'ISO collabore étroitement avec la Commission électrotechnique internationale (IEC) en ce qui concerne la normalisation électrotechnique.

Les procédures utilisées pour élaborer le présent document et celles destinées à sa mise à jour sont décrites dans les Directives ISO/IEC, Partie 1. Il convient, en particulier, de prendre note des différents critères d'approbation requis pour les différents types de documents ISO. Le présent document a été rédigé conformément aux règles de rédaction données dans les Directives ISO/IEC, Partie 2 (voir www.iso.org/directives).

L'attention est appelée sur le fait que certains des éléments du présent document peuvent faire l'objet de droits de propriété intellectuelle ou de droits analogues. L'ISO ne saurait être tenue pour responsable de ne pas avoir identifié de tels droits de propriété et averti de leur existence. Les détails concernant les références aux droits de propriété intellectuelle ou autres droits analogues identifiés lors de l'élaboration du document sont indiqués dans l'Introduction et/ou dans la liste des déclarations de brevets reçues par l'ISO (voir www.iso.org/brevets).

Les appellations commerciales éventuellement mentionnées dans le présent document sont données pour information, par souci de commodité, à l'intention des utilisateurs et ne sauraient constituer un engagement.

Pour une explication de la signification des termes et expressions spécifiques de l'ISO liés à l'évaluation de la conformité, ou pour toute information au sujet de l'adhésion de l'ISO aux principes de l'OMC concernant les obstacles techniques au commerce (OTC), voir le lien suivant: [Avant-propos — Informations supplémentaires](http://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016).

Le comité chargé de l'élaboration du présent document est l'ISO/TC 121, *Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire*, sous-comité SC 2, *Canules et équipement connexe*.

Cette cinquième édition annule et remplace la quatrième édition (ISO 5364:2008) qui fait l'objet d'une révision technique.

Tout au long de la présente Norme internationale, le texte dont un justificatif est fourni dans l'[Annexe A](#) est repéré par un astérisque (*).

Les principales modifications apportées dans la présente édition comprennent de nouvelles méthodes d'essai de lisibilité et les exigences correspondantes, ainsi qu'un code couleur pour indiquer la taille désignée.

Introduction

La présente Norme internationale spécifie les dimensions et autres exigences relatives aux canules oropharyngées.

La taille de la canule oropharyngée est désignée par la longueur, ce qui est important lorsque l'on choisit une canule oropharyngée pour maintenir vers l'avant la base de la langue afin d'éviter l'obstruction des voies aériennes par les tissus mous.

La taille de la canule oropharyngée est indiquée par un marquage lisible et par un code couleur, qui sont importants pour permettre une identification et un choix rapides en situations d'urgence.

iTeh STANDARD PREVIEW (standards.iteh.ai)

[ISO 5364:2016](https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016)

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016>

iTeh STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

ISO 5364:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ae7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016>

Matériel d'anesthésie et de réanimation respiratoire — Canules oropharyngées

1 Domaine d'application

La présente Norme internationale spécifie les exigences relatives aux canules oropharyngées en matière plastique et/ou en caoutchouc, notamment celles qui comportent un renfort inséré en matière plastique et/ou en métal.

La présente Norme internationale ne s'applique pas aux canules oropharyngées en métal, ni ne traite des exigences concernant l'inflammabilité des canules oropharyngées.

L'inflammabilité des canules oropharyngées, par exemple en cas d'utilisation de produits anesthésiques inflammables, d'appareils d'électrochirurgie ou de lasers, représente un danger bien connu. Ce problème est pris en compte par une gestion clinique appropriée, qui ne relève pas du domaine d'application de la présente Norme internationale.

La présente Norme internationale ne s'applique pas aux canules supralaryngées ne comportant pas de mécanisme d'obturation intégré.

2 Références normatives

Les documents ci-après, dans leur intégralité ou non, sont des références normatives indispensables à l'application du présent document. Pour les références datées, seule l'édition citée s'applique. Pour les références non datées, la dernière édition du document de référence s'applique (y compris les éventuels amendements).

ISO 7000, *Symboles graphiques utilisables sur le matériel — Symboles enregistrés*

ISO 10993-1, *Évaluation biologique des dispositifs médicaux — Partie 1: Evaluation et essais au sein d'un processus de gestion du risque*

ISO 11607-1, *Emballages des dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal — Partie 1: Exigences relatives aux matériaux, aux systèmes de barrière stérile et aux systèmes d'emballage*

ISO 15223-1, *Dispositifs médicaux — Symboles à utiliser avec les étiquettes, l'étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux — Partie 1: Exigences générales*

EN 556-1:2001, *Stérilisation des dispositifs médicaux — Exigences relatives aux dispositifs médicaux en vue d'obtenir l'étiquetage STERILE — Partie 1: Exigences relatives aux dispositifs médicaux stérilisés au stade terminal*

EN 1041, *Informations fournies par le fabricant de dispositifs médicaux*

3 Termes et définitions

Pour les besoins du présent document, les termes et définitions suivants s'appliquent.

3.1

canule oropharyngée

dispositif destiné à maintenir la liberté des voies aériennes à travers la cavité buccale et le pharynx

[SOURCE: ISO 4135:2001, 6.1.1]

3.2
extrémité (intra)pharyngée

extrémité de la *canule oropharyngée* (3.1) qui est prévue pour être insérée dans les voies oropharyngées du patient

[SOURCE: ISO 4135:2001, 6.1.1.2]

3.3
extrémité (intra)buccale
extrémité à collerette

extrémité de la *canule oropharyngée* (3.1) qui a une collerette susceptible de s'appliquer sur les lèvres, entre les dents ou les gencives


[SOURCE: ISO 4135:2001, 6.1.1.1]

4 Désignation des tailles et dimensions

4.1 Désignation de la taille

La taille des canules oropharyngées doit être désignée par la longueur nominale, l , (voir [Figure 1](#)), exprimée en centimètres, conformément au [Tableau 1](#).

NOTE La désignation des tailles propre au fabricant peut être donnée en supplément, mais cela n'est pas recommandé.

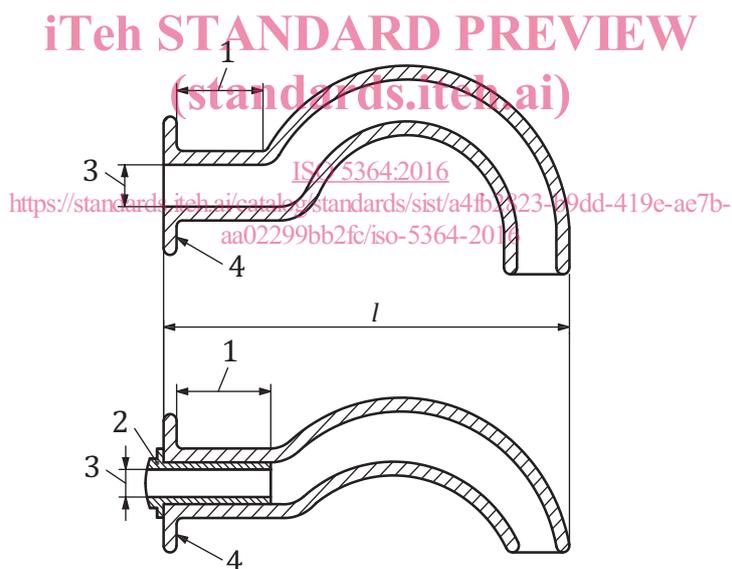

Légende

- 1 pièce buccale
- 2 renfort inséré, s'il est fourni
- 3 position de mesure de la dimension intérieure minimale (voir [Tableau 1](#))
- 4 extrémité à collerette

NOTE Pour l , voir [4.1](#) et [4.2.1](#).

Figure 1 — Dimensions pour la désignation de la taille des canules oropharyngées

Tableau 1 — Désignation de la taille des canules oropharyngées — Dimensions et tolérances

Taille désignée (longueur nominale)	Longueur et tolérance	Dimension intérieure mini- male
cm	mm	mm
3	30 ± 2,5	2,5
3,5	35 ± 2,5	3,0
4	40 ± 2,5	3,0
4,5	45 ± 2,5	3,0
5	50 ± 2,5	3,5
5,5	55 ± 2,5	3,5
6	60 ± 2,5	4,0
6,5	65 ± 2,5	4,0
7	70 ^{+5,0} _{-2,5}	4,0
8	80 ± 5,0	4,5
9	90 ± 5,0	4,5
10	100 ± 5,0	5,0
11	110 ± 5,0	5,5
12	120 ± 5,0	5,5

4.2 Dimensions

(standards.iteh.ai)

4.2.1 La longueur, *l*, (voir [Figure 1](#)) doit être conforme au [Tableau 1](#).

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b->

4.2.2 Les dimensions intérieures minimales sur toute la longueur de la canule ne doivent pas être inférieures à celles spécifiées dans le [Tableau 1](#).

NOTE Cette dimension est pertinente de façon à pouvoir introduire d'autres dispositifs, par exemple une canule d'aspiration dans la canule oropharyngée.

5 Matériaux

Les canules oropharyngées, dans l'état prêt à l'emploi après la préparation recommandée par le fabricant, doivent satisfaire aux essais de sécurité biologique appropriés, tel qu'indiqué dans l'ISO 10993-1.

6 Conception

Les bords et les coins destinés à être en contact avec les tissus des patients doivent avoir un rayon de courbure minimal de 0,5 mm.

7 Exigences de performance

7.1 Résistance à l'aplatissement de la pièce buccale

Lors des essais réalisés conformément à l'[Annexe B](#), les dimensions intérieures minimales de la pièce buccale de la canule ne doivent pas être inférieures à 75 % de celles figurant dans le [Tableau 1](#) pour la taille de canules soumises à essai.

7.2 Non-occlusion de la lumière

Lors de l'essai conformément à l'[Annexe C](#), la non-occlusion de la lumière de la canule oropharyngée doit être maintenue.

8 Assurance de stérilité

Les canules oropharyngées fournies stériles et portant la mention «STÉRILE» doivent satisfaire aux exigences de l'EN 556-1:2001, 4.1.

9 Emballage des canules oropharyngées fournies stériles

9.1 Chaque canule oropharyngée fournie stérile et portant la mention «STÉRILE» doit faire l'objet d'un emballage individuel.

9.2 L'emballage doit constituer une barrière efficace contre la pénétration des micro-organismes et des matières particulaires, conformément à l'ISO 11607-1.

9.3 L'emballage doit permettre d'extraire le contenu de façon aseptique et ne doit pas pouvoir être refermé sans que l'on voie clairement qu'il a été ouvert.

9.4 La taille désignée de la canule doit être apparente par examen visuel du conteneur individuel intact.

9.5 Les emballages individuels doivent être contenus dans un emballage de protection ou de groupage.

10 Marquage

ISO 5364:2016
<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-aa02299bb2fc/iso-5364-2016>

10.1 Généralités

Il convient que le marquage des canules oropharyngées, des emballages individuels et des emballages de protection ou de groupage, ainsi que les informations à fournir par le fabricant, soient conformes à l'EN 1041.


10.2 Utilisation de symboles

L'utilisation des symboles appropriés figurant dans l'ISO 7000 ou dans l'ISO 15223-1 peut permettre de satisfaire aux exigences énoncées en [10.4](#) et en [10.5](#).

10.3 Marquage des canules oropharyngées

10.3.1 L'extrémité à collerette de la canule oropharyngée doit comporter le marquage suivant:

- a) la taille désignée (longueur nominale, en centimètres) conformément à [4.1](#) (voir [Figure 2](#));
- b) le nom et/ou la marque commerciale du fabricant et/ou du fournisseur (voir [Figure 2](#));
- c) une mention de la présence de caoutchouc naturel (latex), le cas échéant.

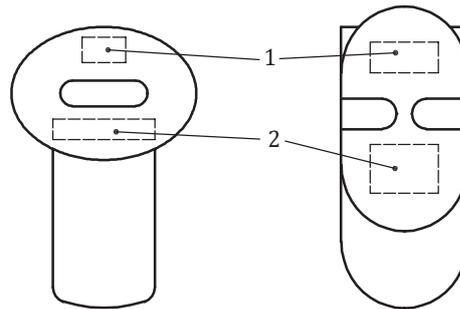

Légende

- 1 taille désignée
2 nom et/ou marque commerciale du fabricant ou du fournisseur

NOTE Les formes indiquées aux [Figures 1](#) et [2](#) ne sont conçues que pour illustrer des modèles communs de canules oropharyngées dans le but de mentionner la taille et le marquage, mais ce ne sont que des exemples.

Figure 2 — Marquage type de l'extrémité à collerette des canules oropharyngées

10.3.2 *Les marquages conformément aux a) et b) doivent être clairement lisibles à partir de l'extrémité à collerette lorsqu'ils sont observés à une distance de $500 \text{ mm} \pm 10 \text{ mm}$ sous un éclairage de $215 \text{ lx} \pm 15 \text{ lx}$ en utilisant une vision normale corrigée si nécessaire.

S'assurer de la conformité par un contrôle visuel.

iTeH STANDARD PREVIEW
(standards.iteh.ai)

10.3.3 *Les canules oropharyngées doivent comporter un code couleur par taille conformément au [Tableau 2](#).

ISO 5364:2016

<https://standards.iteh.ai/catalog/standards/sist/a4fb2823-b9dd-419e-ac7b-a02290021c/iso-5364-2016>

10.3.4 Le code couleur doit être visible à partir de l'extrémité à collerette.

Tableau 2 — Code couleur des canules oropharyngées

Taille désignée	Couleur
3	Lilas
3,5	Vert clair
4	Rose
4,5	Crème
5	Bleu
5,5	Gris
6	Noir
6,5	Brun
7	Blanc
8	Vert
9	Jaune
10	Rouge
11	Orange
12	Violet